

Pedoman Petunjuk Penggunaan

Abilify Maintena®
(aripiprazole)
suspensi injeksi pelepasan lambat

Pre-Filled Dual Chamber 400 mg Syringe
Berikan sekali dalam sebulan





Isi Peralatan:


ABILIFY MAINTENA syringe

Sterile Water for Injection


ABILIFY MAINTENA
Petunjuk Penggunaan

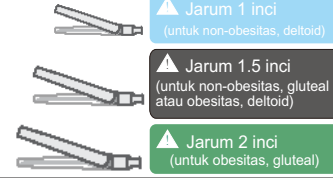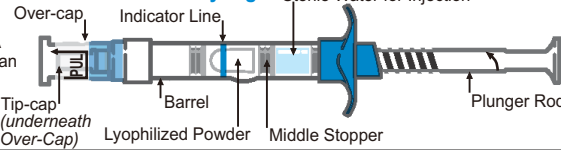


- 1 Untuk melepaskan pelarut, **TEKAN DAN PUTAR** plunger rod hingga **plunger rod benar-benar berhenti**.

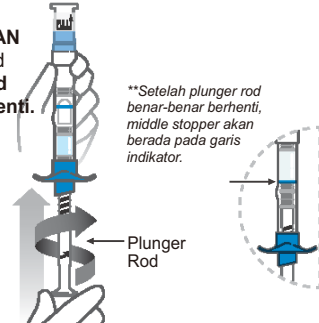

- 2 Secara vertikal, kocok/ goyangkan syringe dengan kuat selama **20 detik** hingga obat tercampur **merata berwarna putih susu**.

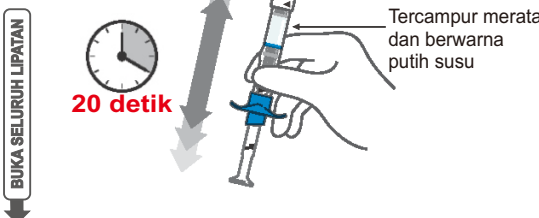


- 3 Putar dan tarik **Over-cap** dan **Tip-cap**.

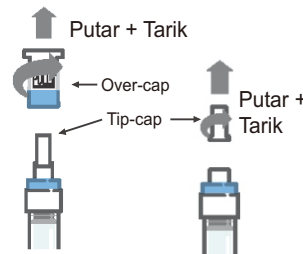


- 4 **Pilih jarum yang sesuai tergantung pada tipe tubuh dan tempat injeksi.**

Tipe tubuh	Tempat Injeksi	Ukuran Jarum
Non-obesitas	Deltoid	1 inci (23G)
	Gluteal	1.5 inci (22G)
Obesitas	Deltoid	1.5 inci (22G)
	Gluteal	2 inci (21G)

- 5 **Sambil memegang needle-cap**, pasang jarum yang sesuai **HINGGA RAPAT**. Lalu tarik needle-cap ke atas

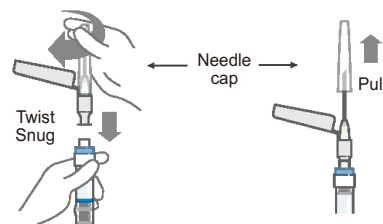


- 6 Tahan syringe dalam posisi tegak. **NAIKKAN PLUNGER ROD PERLAHAN UNTUK MENGELUARKAN UDARA.**

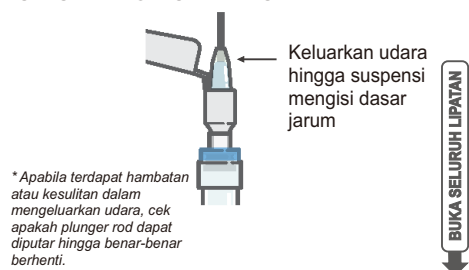

- 7 Secara perlahan suntikkan **ABILIFY MAINTENA** ke dalam tempat injeksi yang sesuai. Suntikkan segera setelah direkonstitusi.



- 8 Pasang pelindung jarum dan buang seluruh komponen peralatan secara hati-hati.

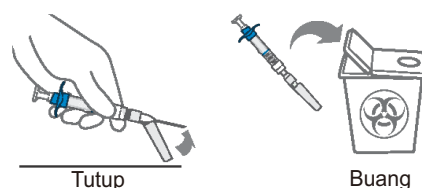

NO. REG. : DK11756101925B1

INFORMASI LENGKAP LIHAT BROSUR
YANG TERDAPAT DALAM DUS

HARUS DENGAN RESEP DOKTER



Diproduksi oleh:
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,
Tokushima Wajiki Factory
306-2, Aza Otsubo, Konii, Naka-cho, Naka-gun,
Tokushima 771-5209, Japan.



Di bawah otorisasi dari:
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Japan



Diimpor dan dikemas ulang oleh:
PT Otsuka Indonesia
Jl. Sumber Waras No.25,
Lawang, Malang 65216, Indonesia

TMLBSBGWxx